


# 15 pH optimum enzymu katalasy

Když se náš enzym cítí nejlépe?



PRACOVNÍ TAHÁK

rev. 1.0

Příprava fosfátových pH pufrů

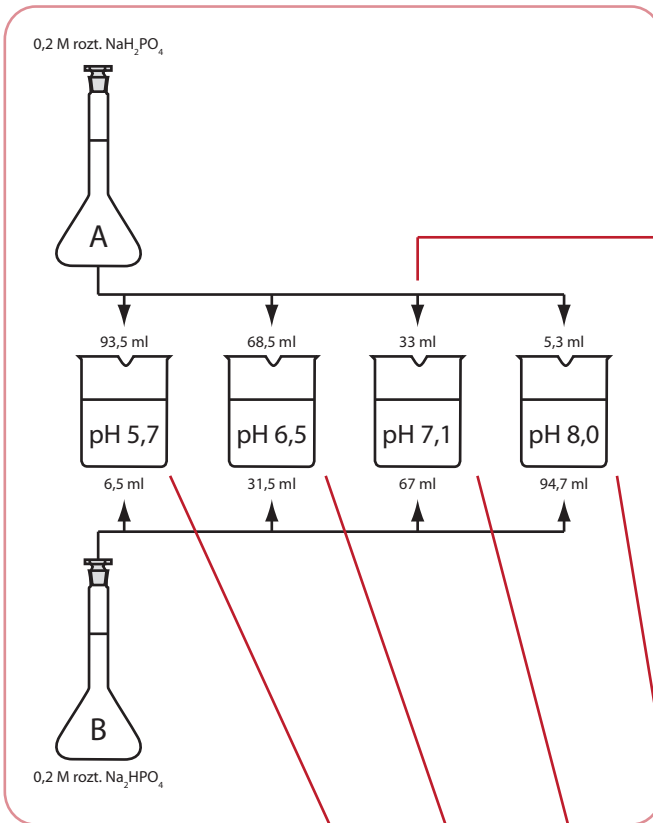

Zpracování biologického materiálu

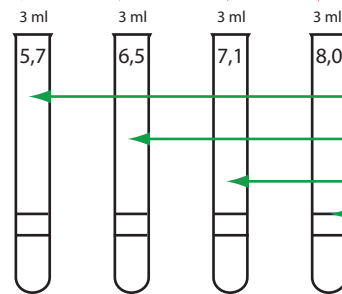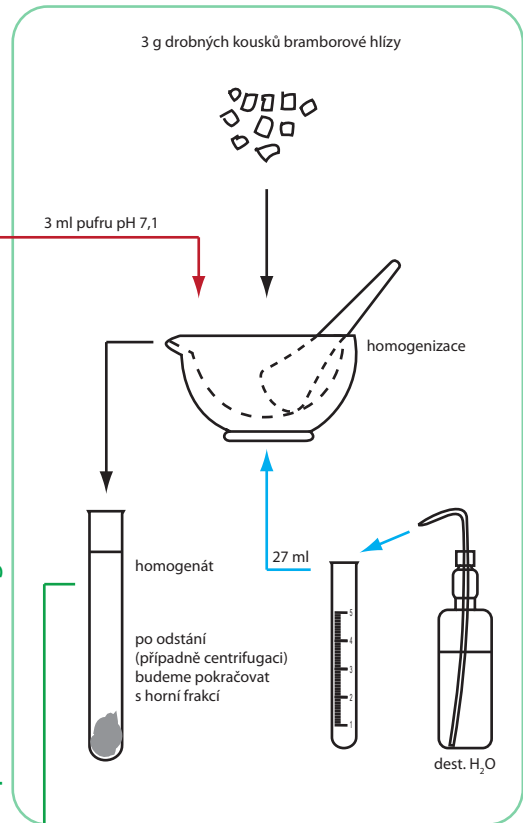

do každé zkumavky pipetujeme po 1 ml horní frakce homogenátu (supernatant)

nechat odstát 3-5 min

aktuálně měřený vzorek přepipetujeme do čisté měřicí zkumavky nebo měříme přímo se stávající zkumavkou

